

# Тестування на ВІЛ

## (скринінг, верифікація, ідентифікація)

Обстеження на ВІЛ-інфекцію передбачає проведення досліджень у декілька етапів:

- **скринінговий етап** (виявлення серологічних маркерів ВІЛ);
- **верифікаційний етап** для підтвердження наявності серологічних маркерів ВІЛ (підтверджувальний етап);
- **ідентифікаційний етап** (обстеження при взятті під медичний нагляд або перед призначенням АРТ особі з позитивним ВІЛ-статусом)

1. Якщо результат скринінгу **негативний**: необхідно надати довідки про негативний ВІЛ-статус.


2. Якщо результат скринінгу **позитивний**: проводимо **верифікаційний етап дослідження**. Після отримання позитивного тесту слід провести другий тест верифікаційного дослідження. Якщо отримано позитивний результат тестування: *повідомлення про діагноз ВІЛ-інфекції*.

3. Якщо отримано **сумнівний результат** тестування (скринінговий позитивний, один верифікаційний тест позитивний, а другий тест – негативний): *повідомлення про невизначений ВІЛ-статус*. Слід провести *повторне тестування через 14 діб*.

4. Якщо результат тестування оцінюється як **невизначений** (скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест позитивний, а другий – недійсний /або скринінговий позитивний, перший верифікаційний тест негативний), то слід провести *повторне тестування того ж дня*.

- Додавання тесту в скринінговому дослідженні

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

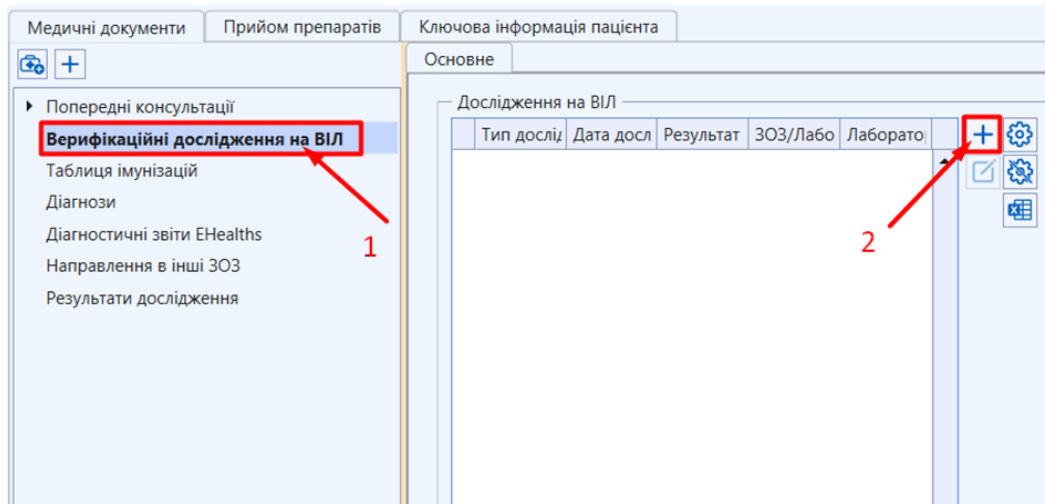

У відкритій картці дослідження необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**.

Далі зберегти картку:

В результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

77

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

First Response, 77R2223S до 10.10.2025

FIRST, 77C0924S до 20.02.2026

**FIRSTR, 77K2223S до 10.10.2025**

Premier Medical, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77B04228 до 31.01.2025

Rapid, 77B0423S до 31.01.2025

Rapid, 77J2023S до 31.10.2025

Експрес-тест ВІЛ 1-2.0, 77K2223S до 31.10.2025

Обрати

Вказати результат тесту та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

FIRSTR, 77K2223S до 10.10.2025

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний Тест відсутній в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергово дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

Додати

Ок Зберегти Скасувати

(Створення)

Назва\*

Серія\*

Термін придатності\*

Eco test

S240305

30.09.2026

Ок Зберегти Скасувати

1

2

3

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Eco test, S240305 до 30.09.2026

Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання Тесту необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле стає обов'язковим) та натиснути вгорі **[Зберегти]** або **[Зберегти і закрити]**.

✓ Зберегти і закрити ✕ Закрити

✓ Зберегти ✕ Аудит  
✕ Видалити ⌚ Історія станів  
🔄 Оновити ⌚ Історія друку

Картка Додатково

Вік пацієнта 38

Організація створення Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* 24.02. Результат дослідження\* ✕

№ направлення 14 № біоматеріалу 14 Лабораторний метод\* **Негативний**  
**Позитивний**  
Розцінюється як неви

ЗОЗ/Лабораторія КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

Тестування на ВІЛ

**Увага!** При додаванні другого тесту скринінгового дослідження система повідомить про помилку:

Помилки картки Результати тестів (Створення)

✕ Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІЛ

Ок

Для типу «**скринінгове дослідження**» можна додати тільки один тест.

Вік пацієнта 38

Організація створення Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ\* **Скринінгове** Дата дослідження\* 24.02. Результат дослідження\* **Позитивний**

№ направлення 14 № біоматеріалу 14 Лабораторний метод\* **Експрес-тестуванн**

ЗОЗ/Лабораторія КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Eco test	S240305	30.09.2026	Позитивний

- Додавання тестів у верифікаційному дослідженні

В ЕМК перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

Медичні документи | Прийом препаратів | Ключова інформація пацієнта

Основне

Дослідження на ВІЛ

Тип дослідж	Дата дослідж	Результат дос	ЗОЗ/Лаборат	Лабораторни
Скринінгове	24.02.2024	Позитивний	КНП БМР "...	Експрес-те...

1. Верифікаційні дослідження на ВІЛ

2. Створити тест

У відкритій картці необхідно обрати «**Тип дослідження на ВІЛ**», вказати дату дослідження, № направлення, № біоматеріалу, ЗОЗ/лабораторія та натиснути кнопку **[Створити тест]**:

Вік пацієнта: 38

Організація створення: Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ\*: Верифікаційне

Дата дослідження\*: 24.02.2024

Результат дослідження:

№ направлення: 15

№ біоматеріалу: 15

Лабораторний метод\*: Експрес-тестування за допом...

ЗОЗ/Лабораторія: Клініко-діагностична лабораторія "Білоцерківська міська лікарня №3"

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
Створити тест			

Далі зберегти картку:

Результат тесту

Для проведення операції необхідно провести збереження картки. Продовжити?

Так Ні

У результаті відкривається картка «**Результати тестів (Створення)**». Необхідно обрати «**Тест**» зі спадного списку:

Результати тестів (Створення)

Тест\*

Результат тесту\*

Обрати тест, увівши його назву в будь-якому порядку

2025

Abbott, 03ADH030C до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADDH036 до 07.01.2025

Bioline HIV 1/2 3.0, 03ADH030C до 07.01.2025

Bioline HIV 1\2 3.0, 03ADI030A до 12.06.2025

boson, 23020903 до 02.02.2025

First Response, 77B0423S до 01.01.2025

First Response, 77K2223S до 10.10.2025

Обрати

Вказати **результат тесту** та натиснути кнопку **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\* boson, 23020903 до 02.02.2025

Результат тесту\* Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

У разі, якщо потрібний **Тест відсутній** в переліку, його можна додати. Для цього натискаємо дію «**Додати**», вказуємо номер, серію, термін придатності (1) та натискаємо по чергової дії **[Зберегти]** та **[Ок]**:

Результати тестів (Створення)

Тест\* ×

Результат тесту\* ×

Додати

Ок Зберегти Скасувати

Якщо тест відсутній у переліку, то необхідно його додати

(Створення)

Назва\* Вериф

Серія\* 78645

Термін придатності\* 30.10.2025

Ок Зберегти Скасувати

Новий тест можна обрати:

Результати тестів (Створення)

Тест\* Вериф, 78645 до 30.10.2025

Результат тесту\* Позитивний

Ок Зберегти Скасувати

Після додавання **2-х Тестів** необхідно обрати «**Результат дослідження**» (поле обов'язкове) та натиснути вгорі **[Зберегти]** або **[Зберегти і закрити]**:

✓ Зберегти і закрити ✕ Закрити ✓ Зберегти ✕ Аудит ✕ Видалити ✕ Історія станів ✕ Оновити ✕ Історія друку

Картка Додатково

Вік пацієнта 38

Організація створення Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"

Тип дослідження на ВІЛ\* Верифікаційне Дата дослідження\* 02.20. Результат дослідження\* ✕

№ направлення 15 № біоматеріалу 15 Лабораторний метод\* Позитивний

ЗОЗ/Лабораторія КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"

Негативний  
Позитивний  
Розцінюється як неви

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний

**Увага!** При додаванні третього тесту верифікаційного дослідження система повідомить про помилку:

Помилки картки Результати тестів (Створення)

✕ Перевищено допустиму кількість результатів тестування для обраного типу дослідження на ВІ

Ок

Для типу «верифікаційне дослідження» можна додати тільки **два тести**:

Вік пацієнта 38

Організація створення Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"


Тип дослідження на ВІЛ\* Верифікаційне Дата дослідження\* 24.02. Результат дослідження\* Позитивний

№ направлення 15 № біоматеріалу 15 Лабораторний метод\* Експрес-тестуванн

ЗОЗ/Лабораторія КНП БМР "Білоцерківська міська лікарня №3"

Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту
test	2424	04.07.2025	Позитивний
Вериф	78645	30.10.2025	Позитивний


**Увага!** Без проведення скринінгового тестування не можна створити верифікаційне.  
Система видає повідомлення про помилку:

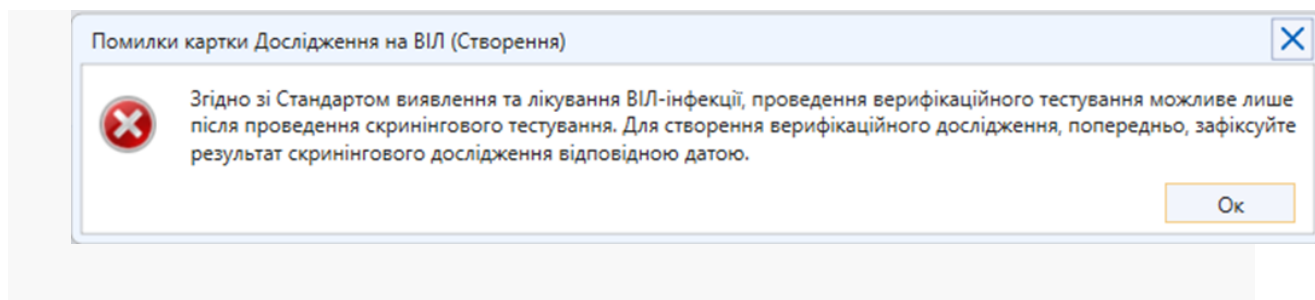

- Додавання тестів у ідентифікаційному дослідженні

У всіх пацієнтів, в яких діагностовано ВІЛ-інфекцію, проводять ідентифікаційний етап під час взяття під медичний нагляд або перед призначенням АРТ, використовуючи ту саму стратегію та алгоритм тестування.

Відкрити ЕМК та перейти на гілку «**Верифікаційні дослідження на ВІЛ**» та натиснути кнопку **[Створити]**:

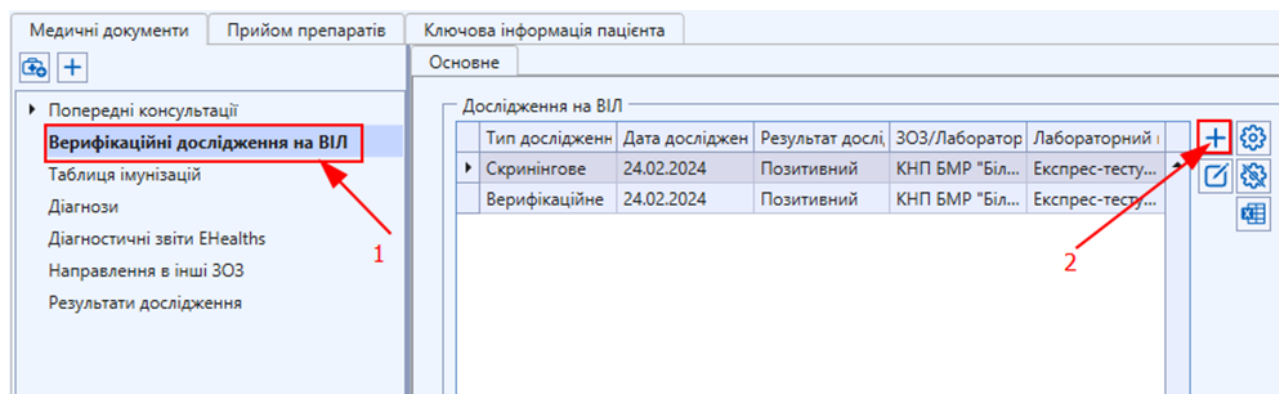


Додавання тестів у ідентифікаційному дослідженні проводиться аналогічно, як і при скринінговому та верифікаційному дослідженнях.

**Увага!** Для типу «ідентифікаційне дослідження» можна додати тільки три тести:

Вік пацієнта	38				
Організація створення	Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №3"				
Тип дослідження на ВІЛ*	Ідентифікаційне	Дата дослідження*	26.02.21	Результат дослідження*	Позитивний
№ направлення	18	№ біоматеріалу	18	Лабораторний метод*	Експрес-тестування за
ЗОО/Лабораторія	Клініко-діагностична лабораторія "Білоцерківська міська лікарня №3"				
Назва тесту	Номер серії тесту	Термін придатності тесту	Результат тесту		
Bosson	2541978	28.09.2026	Позитивний		
Тестова назва	AA1223	27.06.2027	Позитивний		
Тест HIV	AA1212	19.09.2026	Позитивний		

Якщо додати **більше трьох** тестів **ідентифікаційного дослідження**, то система повідомить про помилку.



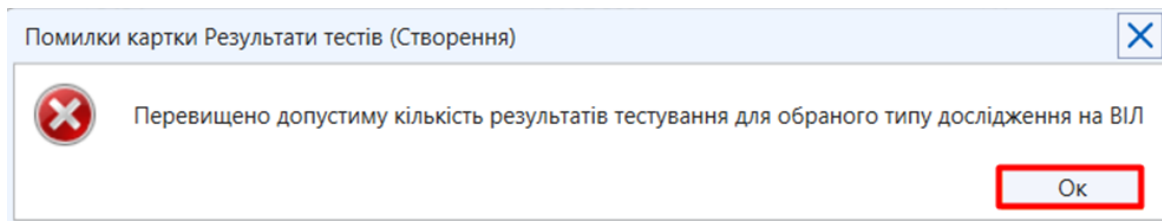

---

Версія #19

Олена Філіпчук створив 2 жовтень 2024 09:29:42

Національний адміністратор оновив 2 жовтень 2024 12:23:06